



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



CİHAZ ADI

DATALOGER

TIBBİ VE TEKNİK  
ÖZELLİKLER

1. Cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz ekranında sıcaklık, nem, saat, bilgileri net bir şekilde okunabilmelidir.
3. Cihaz Windows XP (SP3 ve üzeri), Windows Vista (SP1 ve üzeri), Windows 7 sistemlerle uyumlu çalışabilmelidir.
4. Cihazın 50.000 değer kaydedebilen hafızası bulunmalıdır.
5. Ayarlanabilir alt üst sıcaklık ve nem alarmı bulunmalıdır.
6. Cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır ;

Sıcaklık ölçüm aralığı	: 0°C ... 50°C
Sıcaklık hassasiyeti	: ±1°C
Sıcaklık çözünürlüğü	: 0,1°C
Nem ölçüm aralığı	: % 0 ... 99 rh
Nem hassasiyeti	: %3 rh
Nem çözünürlüğü	: %0,1 rh
Ayarlanabilir kayıt aralıkları	: 1 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk, 30 dk, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 6 saat
Hafıza kapasitesi	: 50.000
Boyutları	: 137 x 98 x 26 mm
Ağırlık	: 430 gr
Alarm özelliği	: Var
Güç kaynağı	: 3 adet 1,5 V AA pil

GENEL  
HUSUSLAR

1. Yüklenici aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

KABUL/MUAYENE  
VE  
TESLİMAT  
ŞARTLARI

1. Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.
2. Yüklenici firmanın teslim edeceği cihazlar TSE ve/veya CE belgeli, en az 2 yıl cihaz garantili olmalı ve İstanbul'da yaygın servis ağı bulunmalı ve ilgili katalog, broşürleri ihale komisyonuna teslim etmelidir.
3. Yüklenici Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB' den İş sağlığı ve Güvenliği eğitim ve hizmetlerini alıyor olmalı ve birer sözleşme suretlerini ihale komisyonuna teslim etmelidir.
4. Yüklenici, cihazı monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
5. Cihazın parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Orhan BARLAS  
Tıp ve Şifir Cerrahisi  
Anabilim Dalı Başkanı

İMZA-KAŞE

Uzm. Hem. Meryem KUBAŞ  
Dip. Tescilli No: 592  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Teyin - Sıra Cerrahisi Anabilim Dalı  
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Dr. M. Sezer ÖZGÜN



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



TEKNİK SERVİS  
GARANTİ VE  
YEDEK PARÇA

1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

MONTAJ

1. Yetkili firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

EĞİTİM

1. Yüklenici, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

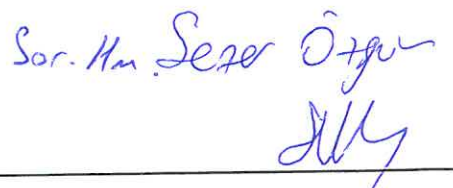
İMZA-KAŞE

  
İsmail Barlas  
Tıp Fakültesi  
Cerrahi Servis Sorumlusu

İMZA-KAŞE

  
Dr. Teşci Kubas  
Dış Tıp Fakültesi  
İstanbul Tıp Fakültesi  
İnir Cerrahisi Anabilim Dalı  
Tıbbi Hizmetleri Sorumlusu

İMZA-KAŞE

  
Sor. M. Sezer Özgür